

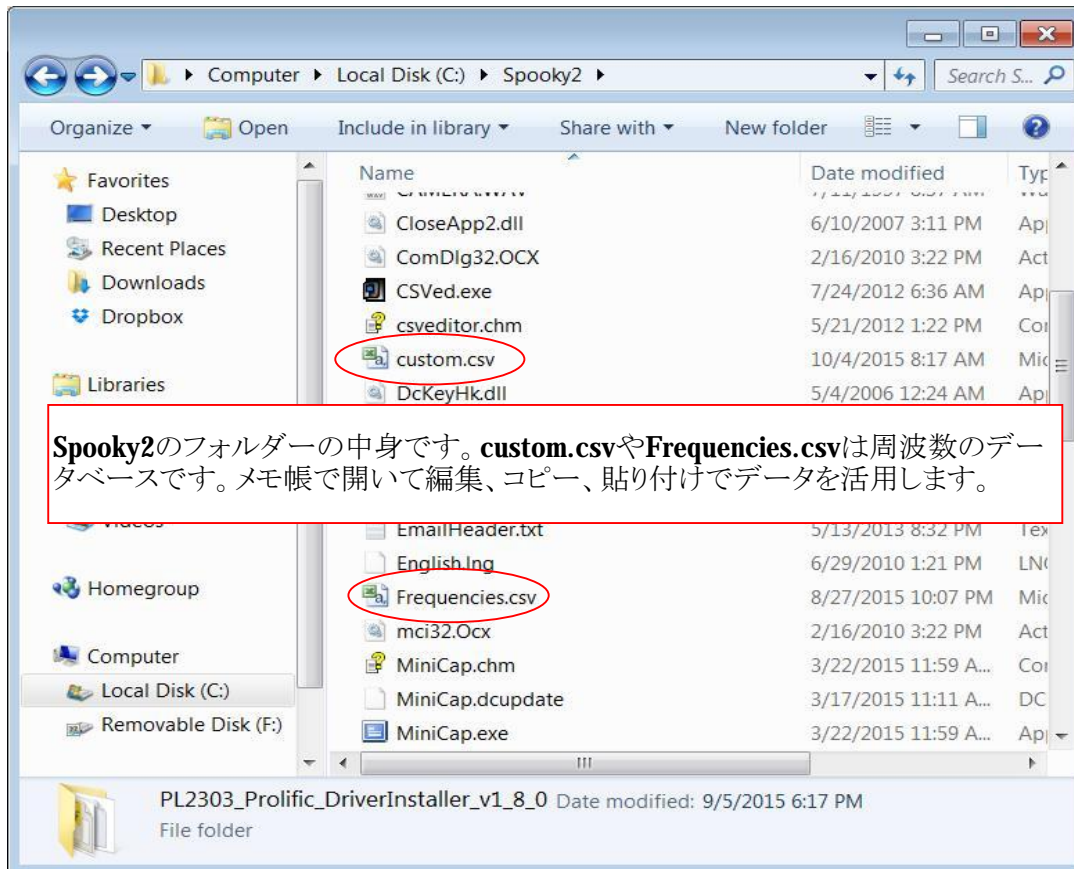
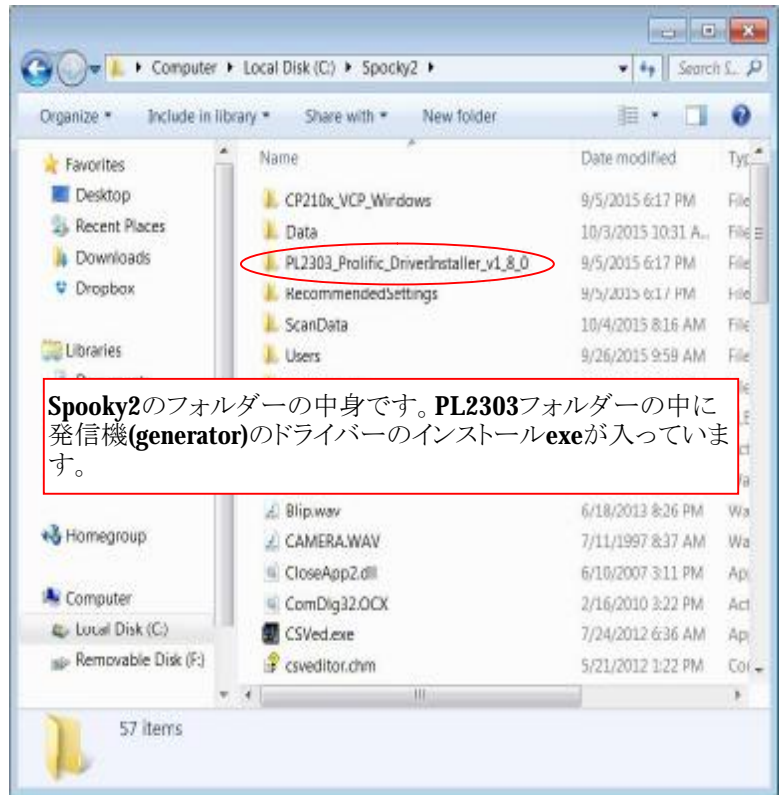
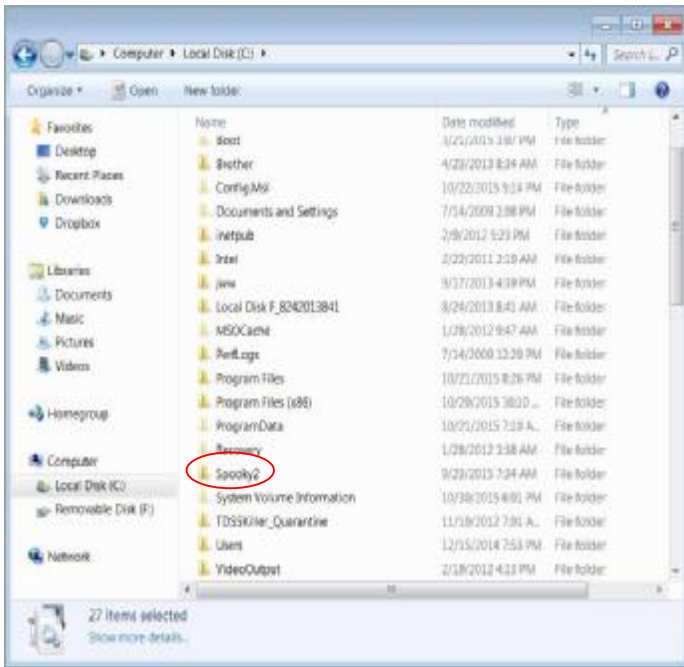


Spooky2は、CドライブのSpooky2フォルダーにインストールされます。

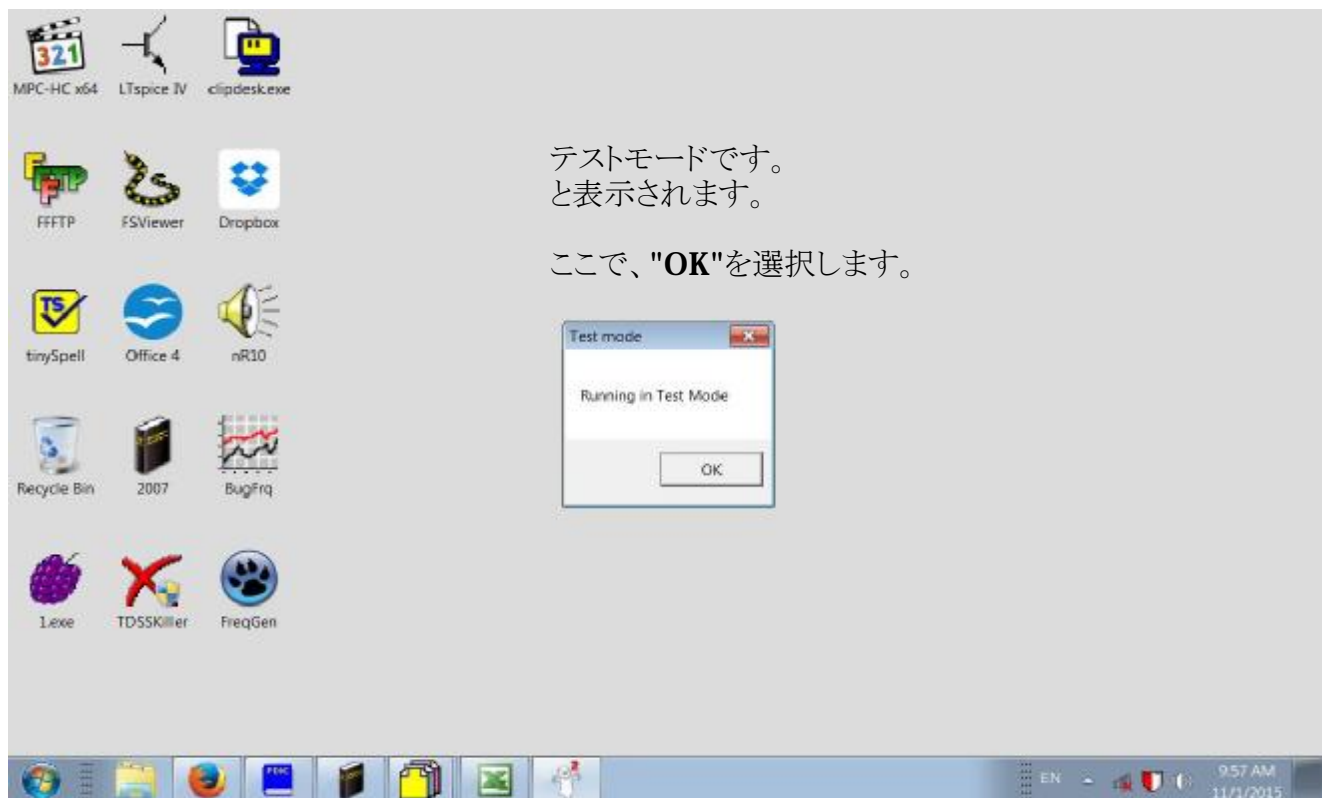

インストール後、スプーキー2 ソフトを起動すると、ドライバーのインストールを尋ねて来ます。このとき**No**を選べるとテストモードで起動します。

Yesを選べるとジェネレータ(周波数発生装置)のドライバーがインストールされます。実際にジェネレータを使用する場合は、最初にジェネレータを**PC**に接続して電源を**On**にして後にソフトを起動します。ここでは、テストモードの起動を説明しています。

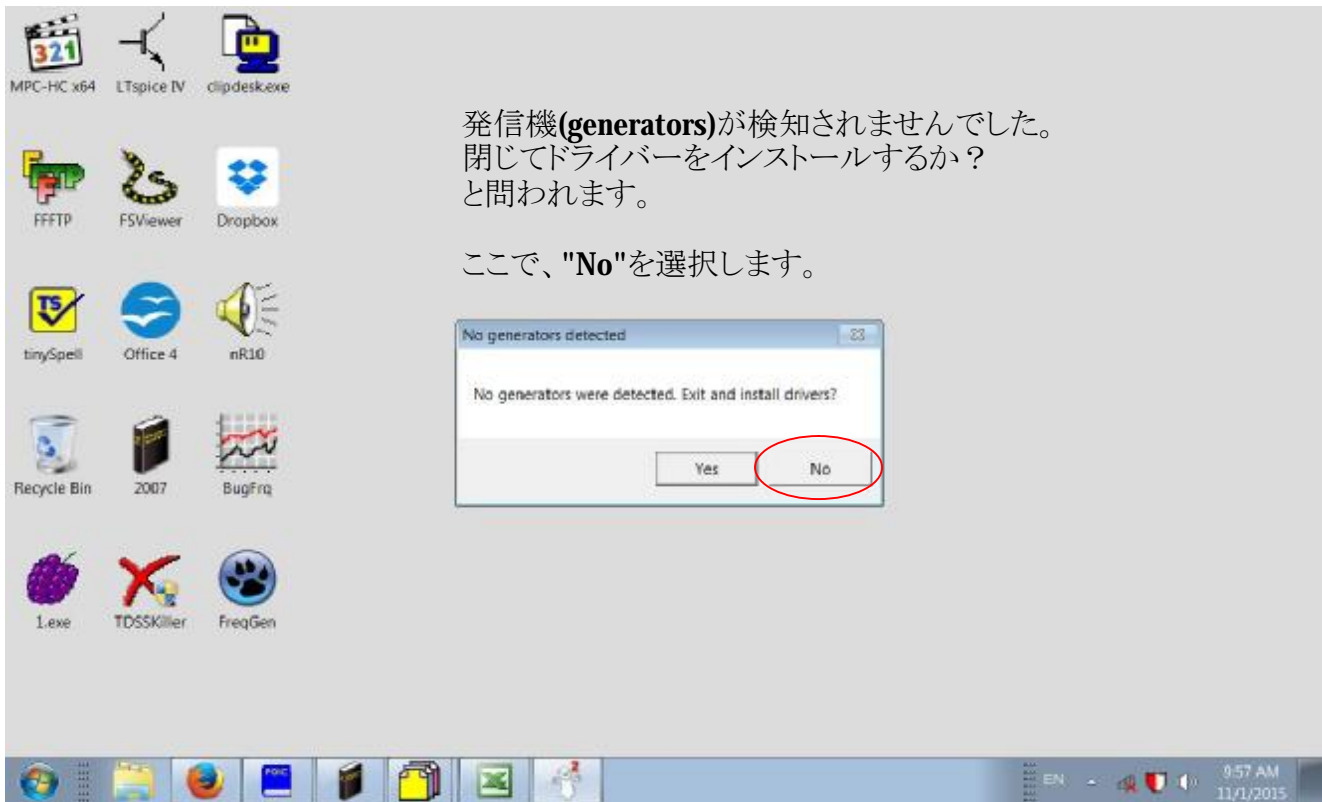

テストモードで起動したところ

病原菌と周波数のデータベース

Condition	Program	Frequencies
Abdominal Cramps	XTRA	72,95,190,304
Abdominal Inflammation	CAFL	2720,2489,2170,1965,1800,1600,1550,880,832,802,787,776,727,660,465,450,444,440,429
Abdominal Pain	CAFL	10000,3000,95,3,3040,522,440,160,124,26
Abdominal Pain	XTRA	5000,10000
Abscess Wocardia Asteroide	XTRA	228,231,237,694,710,887,2890,11092.19,11096.87,17679.38
Abdominal ?	XTRA	2720,2170,1965,1550,880,802,787,777,500,444,190

テストモードでは、PCに発信機は接続されていませんが、ダミーが126個表示されます。実際は接続された個数が表示されます。

ジェネレータはPCに接続されていないテストモードでも色々な設定をすることができます。ジェネレータを接続すると接続したチャンネルから周波数を出すことができます。

アドバンスメニューをクリックして幾つかの設定をします。

- リフレッシュ・レートを15.66にする。音が出るようにする。
- Double HRV tolerance をチェックする。
- ソーシャル・メディアサイトのチェックを外す。

ブラックリスト周波数に1840と1910とを追加する。

PCにジェネレータを接続して、ソフトを起動すると、接続したジェネレータの数だけ、チャンネルが表示され、チャンネルから周波数を利用できるようになります。



Spooky2 15th September 2015 (c) John White

File Database Global Online Utils Advanced Menu Help

Searchs Clear

12/11/2015 8:13:28 PM Database

Zygomycosis	CAPL	942, 623, 733
Zygomycosis	KHZ	140, 490, 730, 950, 97500, 175330, 476500, 527000, 667000, 752700
Zygomycosis	VEGA	942
sk20150913	CUST	95740, 99160, 99320, 109240, 113440, 97880, 99020, 124180, 125940, 108280, 143400,
sk20150915	CUST	113760, 139500, 122720, 113860, 79020, 136640, 104300, 78920, 77720, 122660, 78960,
sk20151015	CUST	141640=180, 139400, 139520, 139360, 141680, 145140, 144880, 141540, 141460, 10990,

Program Options

Frequency Multiplier: 1, Duty Cycle: 50, Out 1: 50, Out 2: 50, %

Repeat Every Freq: 1, Amplitude: 20, 20, V

Repeat Each Sat: 1, Offset: 0, 0, %

Repeat Program: 0, Phase Angle: 0, 0, °

Detail Multiplier: 1

Amplitude Wobble: Disabled, 0, %, 16, Steps

Frequency Wobble: Disabled, 0, %, 16, Steps

Amplitude Ramp: 5, Up, Down

Reduce Amplitude < 10 MHz

7.63 Hz Gate

Randomized

Skip Concurrent Duplicate Freq

Remove Duplicate Frequencies

Override Pause Schedule

Prevent Global Start

Out 2 Control

Out 2 = (Out 1 X) 1 0 Hz

Out 2 = (Out 1 X) 1 0 volts

Swap Waveform 0 Seconds

Copy Gate

Stop when Out 1 stops

Waveform

Spike Length Ratio

Spectrum %

F2 = F1 X 1 Hz 0

Add F1 to F2

Spooky2 Detox 1

Channel 4

Program/Robot Name

User Data

Email(s)

Allow Channel Overrides

Every time

Enable Emails

Send Screenshot

Send Error Log

Email Message

Notes

Send Email

Save As

GC:1 CH:4 DX:rw21102 RX: TE:0 WE:3 RE:374 CE:4 LE:rw21102 P0:0 P1:0 P2:0 P3:0 P4:0

1個のジェネレータが接続されている。チャンネルはここでは、4となっている。

